



Anschluss des ICD2 an das PIC-Entwicklungsboard

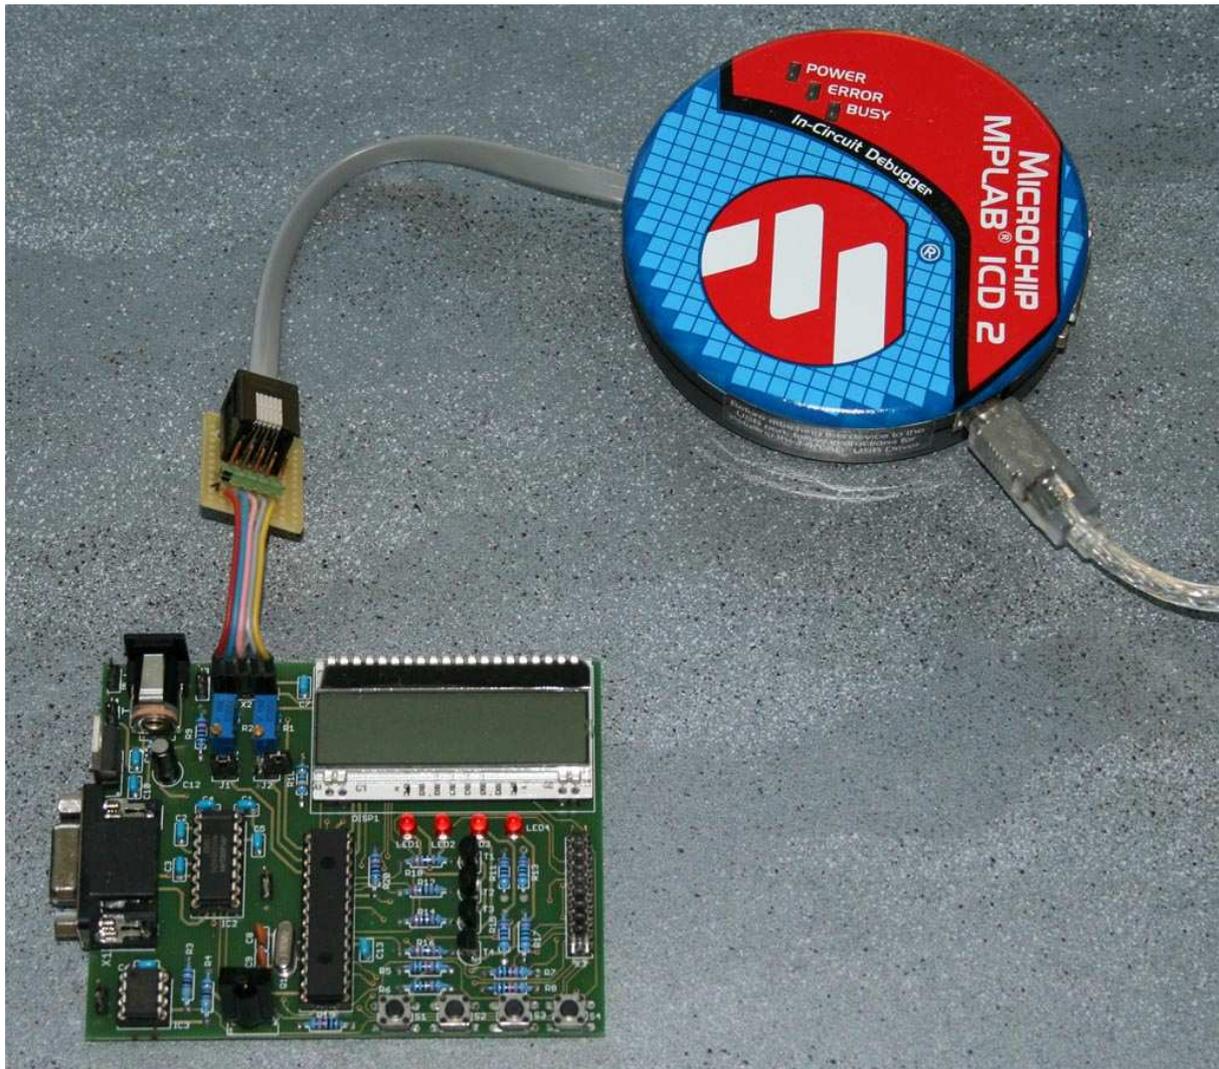

Der ICD2 kann direkt mit dem Entwicklungsboard verbunden werden. Am einfachsten geht dies, indem man sich eine kleine Adapterleiterplatte von dem RJ11 Stecker auf eine Buchsenleiste lötet.

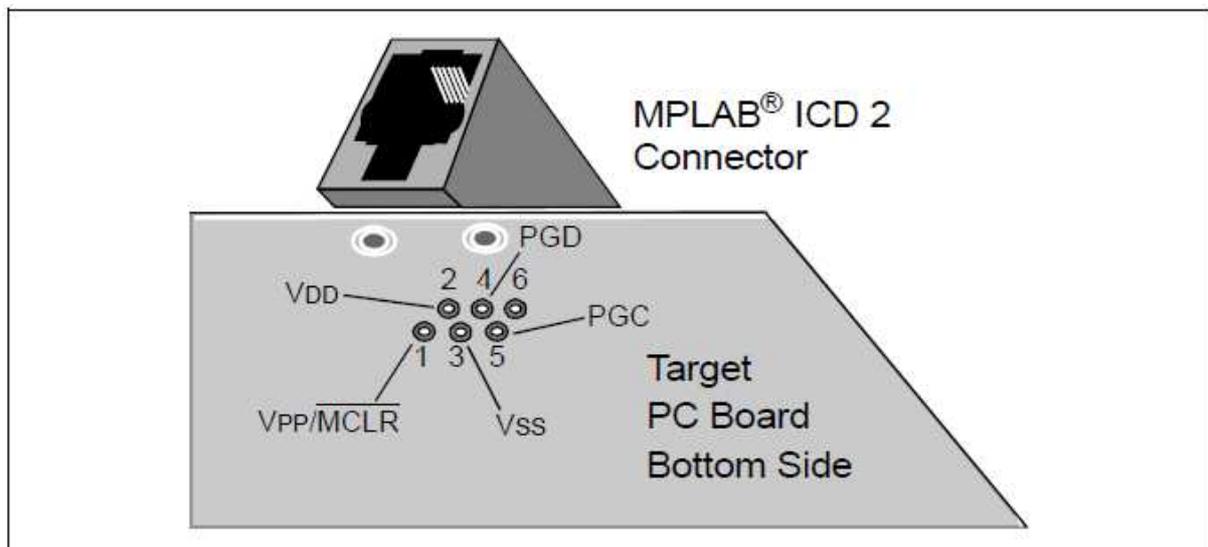

Anschluss des Mini-Pic-Programmiers an das PIC-Entwicklungsboard

